


M 13 Schwingende Saite

Einstellung am Sensoreingang:

-10V .. 10V

Messparameter:

Intervall: 20 μ s, Messzeit 0,3s

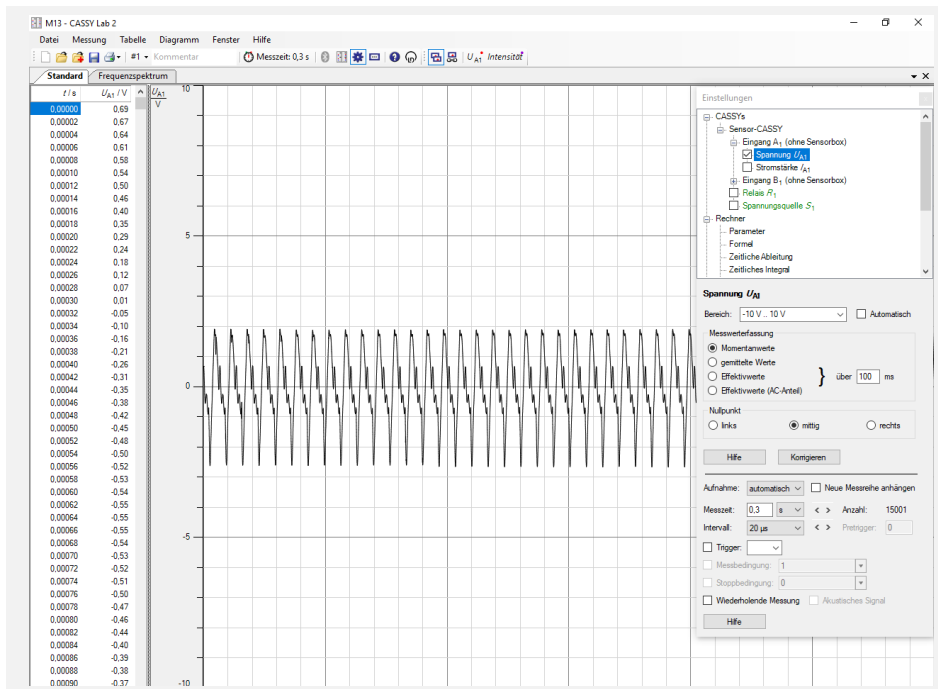

Unter **Einstellungen** > **Rechner** > **FFT** > **Neu** die Fast Fourier Transformation starten. In einer neuen Darstellung wird automatisch das Frequenzspektrum dargestellt.

